



PROMOTIONS | 2025
DU 01 SEPTEMBRE AU 31 OCTOBRE



L'EXCELLENCE AU SERVICE DES CABINETS DENTAIRES



**AVALON
BIOMED**
Advanced Bioceramics



Matériel premium, design moderne, décliné en plusieurs couleurs pour s'adapter à votre environnement. Avec Prodentalpes, offrez à votre cabinet des équipements alliant performance, confort et esthétique.

NOS ATOUTS

- ✓ **Qualité et fiabilité** – Des produits sélectionnés pour leur durabilité et leur efficacité
- ✓ **Confort et ergonomie** – Pensés pour améliorer l'expérience des praticiens et des patients.
- ✓ **Service expert et réactif** – Un accompagnement personnalisé pour répondre à vos besoins.

CONTACTEZ-NOUS

✉ contact@prodentalpes.fr

☎ 06 01 21 16 35



prodentalpes.fr

ZI DES DRAGIEZ, 30 RUE DE GRÉBELIN,
74800 LA ROCHE-SUR-FORON

NeoPUTTY®

MATÉRIAU DE TRAITEMENT PRÉMÉLANGÉ DES RACINES ET DE LA PULPE



Seringue sans déchets
avec embout à piston

La facilité d'utilisation de NeoPUTTY offre des résultats prévisibles et de qualité constante dans un environnement sec ou humide, qu'il s'agisse de combler une perforation, de réaliser une thérapie pulpaire vitale ou une chirurgie apicale.

– Sayeed Attar, DDS, MS
Endodontiste


UNE NORME SUPÉRIEURE EN MATIÈRE DE BIOCÉRAMIQUE

NeoPUTTY est prémélangé et optimisé pour une manipulation et une mise en place plus efficace. Sa consistance ferme et peu collante, sa résistance au rinçage et sa bioactivité en font le premier biocéramique pour vos procédures les plus importantes.

NeoPUTTY offre d'excellentes performances pour les procédures dentaires en contact avec la pulpe vitale et les tissus périradiculaires.

LA RADIOCAPACITÉ LA PLUS ÉLEVÉE DE SA CATÉGORIE

Radiopacité équivalente à 8,1 mm Al.

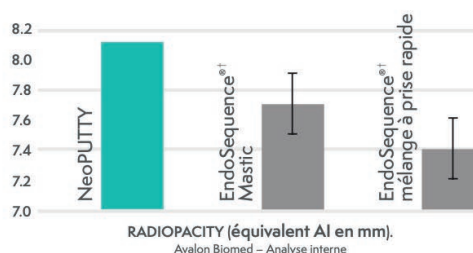

[†] EndoSequence® BC RRM-Putty™ and BC RRM-Fast Set Putty™ are trademarks of Peter Brasseler Holdings LLC.

¹ J Dent. 2014 May;42(5):517-33. A review of the bioactivity of hydraulic calcium silicate cements.

Niu LN, Jiao K, Wang TD, Zhang W, Camilleri J, Bergeron BE, Feng HL, Mao J, Chen JH, Pashley DH, Tay FR.

DIMENSIONNELLEMENT STABLE

Sans rétraction pour assurer un joint sans interstice, minimisant les possibilités d'infiltration bactérienne.

NeoPUTTY 0.08% d'expansion

ADA 57 std. ≤1% de retrait & ≤0.1% d'expansion

RÉSISTANT AU RINÇAGE IMMÉDIAT

Reste en place pour que vous puissiez compléter efficacement la procédure, en assurant un bénéfice bioactif.

TEMPS DE TRAVAIL PROLONGÉ



**Prise in vivo en présence d'humidité

1 NEO PUTTY ACHETÉ, 1 BASELINER OFFERT FOND DE CAVITÉ (AUTO & PHOTO)



✓ **OFFRE DES RÉSULTATS PRÉVISIBLES ET DE QUALITÉ CONSTANTE DANS UN ENVIRONNEMENT SEC OU HUMIDE**

Qu'il s'agisse de combler une perforation, de réaliser une thérapie pulpaire vitale ou une chirurgie apicale. Un coiffage pulpaire, une effraction pulpaire, une pulpotomie (**équivalent Biodentine - trisilicate de calcium**)

✓ **UTILISATION**

- 1- Mettre le produit de Neoputty au bout de l'instrument à l'endroit voulu.
- 2- Dans la séance, mettre du Base/Liner Activa qui est auto-photo et qui dégage du fluor, du phosphate de calcium (Ref : VB2), Biocompatible avec le Neoputty.
- 3- Vous pouvez à la suite mettre du composite dessus sur la base liner VB2 durant la séance.

NEOPUTTY®

Coiffage pulpaire



Packaging : Kit de 0,5 g

Prix public par 1 : 69€^{TTC} / 57,50€^{HT}

Prix public par 3 : 64€^{TTC} / 53,33€^{HT}

Packaging : Kit de 1,2 g

Prix public : 149€^{TTC} / 124,17€^{HT}

Réf : NNPPK NuSmile
Packaging : Kit de 2,4 g

(2 seringues NuSmile de 1,2 g)

Prix public : 289€^{TTC} / 240,83€^{HT}



ACTIVA™ BioACTIVE-BASE / LINER™

Protéger, reminéraliser, restaurer



En savoir plus

Caractéristiques principales

- Les propriétés physiques et bioactives aident à protéger la santé de la pulpe et de la dentine
- La libération de calcium, de phosphate et de fluor favorise la reminéralisation
- La résine hydrophile s'adapte intimement à la dentine et la rend étanche
- La résine caoutchoutée, solide et durable, absorbe les chocs et les forces occlusales
- Distribution contrôlée et mise en place précise grâce à des embouts flexibles
- Ne contient pas de bis-GMA, ni de bisphénol A, ni de dérivés du BPA

Utilisation optimale :


- Mettre le neoputty , trisilicate de calcium (équivalent biodentine)
- Mettre ensuite le bioactive base-liner

! LA PULPE N'EST PAS PLATE !

Les couronnes postérieures NuSmile ZR ont une anatomie occlusale uniforme et fine qui suit les contours de la surface occlusale de la dent naturelle, ce qui réduit le risque d'exposition pulpaire par rapport à la conception "Flat-fit" de certaines autres couronnes. Les marques concurrentes de couronnes postérieures en zircone avec un design occlusal "Flat-fit" ont été sujettes à des échecs de cas probablement dus à des expositions pulpaires iatrogènes.


POURQUOI S'Y RISQUER ?

NuSmile CONTOUR-FIT

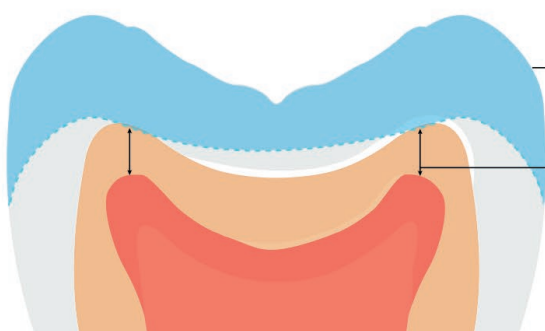

- **Moins de risques d'exposition** pulpaire grâce aux contours naturels de la couronne ZR de NuSmile
- **Moins de taille dentaire nécessaire.** Réduction totale de 1 à 1,5 mm en suivant les contours naturels de l'occlusion.

Autres marques FLAT-FIT

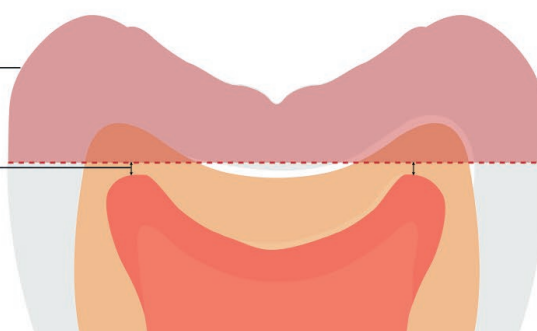

- **Peut être sujet à des échecs** dus à l'exposition iatrogène de la pulpe.
- **Une taille plus importante des dents est nécessaire**

ÉPAISSEUR MINIMALE RÉSISTANCE MAXIMALE

NUSMILE ZR


SURFACE OCCLUSALE
PLUS FINE



0.2mm de marge


SPRIG

SURFACE OCCLUSAL
PLUS ÉPAISSE

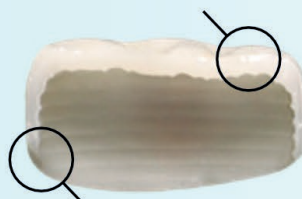

0.5mm de marge


RÉSISTANCE À
LA FRACTURE
2X PLUS
ÉLEVÉE

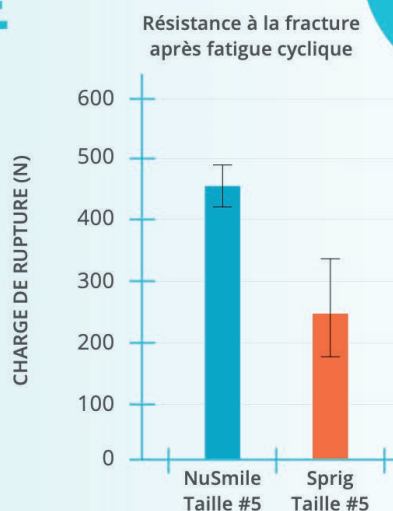

INFORMATIONS	
Nom du cabinet :	Téléphone :
Adresse :	Complément d'adresse :
Code postal :	Ville :
Email :	Mobile :
Nom du Dr :	Nom de l'assistante :

BIOCÉRAMIQUES / MTA	CODE	QTÉ
NeoPUTTY 0,5g	NNPIK	
NeoPUTTY 1,2g	NNPMK	
NeoPUTTY 2,4g	NNPPK	
NeoMTA 2 1g	NMTA21.0	
NeoMTA 2 2,5g	NMTA22.5	
Plaque de verre pour mélange	SPN200	

KIT COURONNES ACIER	NOMBRE DE COURONNES	PRIX TTC
☐ Kit Évaluation canine (EKC604)	24	156€
☐ Kit Démarrage canine (SKC604)	120	780€
☐ Kit Professionnel canine (PKC604)	240	1560€
☐ Kit Évaluation postérieur (EK606)	24	156€
☐ Kit Démarrage postérieur (SK606)	120	780€
☐ Kit Professionnel postérieur (PK606)	240	1560€
☐ Master Kit (MKSS600)	264	1716€

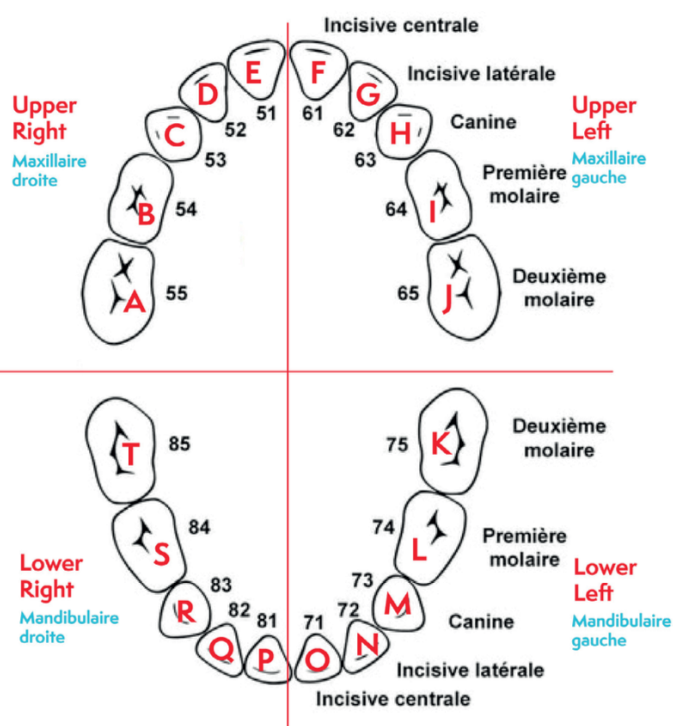

KIT ET PACK ZIRCON	NOMBRE DE COURONNE	TYPE DE KIT	PRIX TTC
Kit d'évaluation	16	☐ Incisive Centrale / Latérale / Universelle (EK204L) ☐ Canine (EKC204L) ☐ Molaire permanente (EK250A2) 1ère molaire : ☐ Normale (EKD206L) ☐ Étroite (EKD207L) 2ème molaire : ☐ Normale (EKE206L) ☐ Étroite (EKE207L)	480€
Kit de démarrage	40	☐ Incisive Centrale / Latérale / Universelle (SK204L) ☐ Canine (SKC204L) ☐ Molaire permanente (SK250A2) 1ère molaire : ☐ Normale (SKD206L) ☐ Étroite (SKD207L) 2ème molaire : ☐ Normale (SKE206L) ☐ Étroite (SKE207L)	1200€
Kit Pro	84	☐ Incisive Centrale / Latérale / Universelle (PK204L) ☐ Canine (PKC204L) ☐ Molaire permanente (PK250A2) 1ère molaire : ☐ Normale (PKD206L) ☐ Étroite (PKD207L) 2ème molaire : ☐ Normale (PKE206L) ☐ Étroite (PKE207L)	2520€
Kit Master postérieur	80	☐ Postérieure classique (MKP206L) 1ère molaire étroite + 2ème molaire normale ☐ Postérieure étroite (MKPN207L) 1ère molaire étroite + 2ème molaire étroite	2400€
Kit Master antérieur	56	☐ Primaire antérieure (MKA204L)	1680€

COURONNES ZIRCON

#E (51) INCISIVE CENTRALE MAXILLAIRE DROITE			
REFILL	QTÉ	TRY-IN	QTÉ
A0R204L		A0R304	
A1R204L		A1R304	
A2R204L		A2R304	
A3R204L		A3R304	
A4R204L		A4R304	
A5R204L		A5R304	
A6R204L		A6R304	

#F (61) INCISIVE CENTRALE MAXILLAIRE GAUCHE			
REFILL	QTÉ	TRY-IN	QTÉ
A0L204L		A0L304	
A1L204L		A1L304	
A2L204L		A2L304	
A3L204L		A3L304	
A4L204L		A4L304	
A5L204L		A5L304	
A6L204L		A6L304	

#D (52) INCISIVE LATÉRALE MAXILLAIRE DROITE			
REFILL	QTÉ	TRY-IN	QTÉ
B0R204L		B0R304	
B1R204L		B1R304	
B2R204L		B2R304	
B3R204L		B3R304	
B4R204L		B4R304	
B5R204L		B5R304	
B6R204L		B6R304	

#G (62) INCISIVE LATÉRALE MAXILLAIRE GAUCHE			
REFILL	QTÉ	TRY-IN	QTÉ
B0L204L		B0L304	
B1L204L		B1L304	
B2L204L		B2L304	
B3L204L		B3L304	
B4L204L		B4L304	
B5L204L		B5L304	
B6L204L		B6L304	

#N, O, P, Q (72, 71, 81, 82) MANDIBULAIRE UNIV.			
REFILL	QTÉ	TRY-IN	QTÉ
U1204L		U1304L	
U2204L		U2304L	
U3204L		U3304L	
U4204L		U4304L	

#C (53) CANINE MAXILLAIRE DROITE			
REFILL	QTÉ	TRY-IN	QTÉ
C0R204L		C0R304	
C1R204L		C1R304	
C2R204L		C2R304	
C3R204L		C3R304	
C4R204L		C4R304	
C5R204L		C5R304	
C6R204L		C6R304	

#H (63) INCISIVE CENTRALE MAXILLAIRE GAUCHE			
REFILL	QTÉ	TRY-IN	QTÉ
C0L204L		C0L304	
C1L204L		C1L304	
C2L204L		C2L304	
C3L204L		C3L304	
C4L204L		C4L304	
C5L204L		C5L304	
C6L204L		C6L304	

#R (83) INCISIVE LATÉRALE MANDIBULAIRE DROITE			
REFILL	QTÉ	TRY-IN	QTÉ
LC0R204L		LC0R304	
LC1R204L		LC1R304	
LC2R204L		LC2R304	
LC3R204L		LC3R304	
LC4R204L		LC4R304	
LC5R204L		LC5R304	
LC6R204L		LC6R304	

#M (73) INCISIVE LATÉRALE MANDIBULAIRE GAUCHE			
REFILL	QTÉ	TRY-IN	QTÉ
LC0L204L		LC0L304	
LC1L204L		LC1L304	
LC2L204L		LC2L304	
LC3L204L		LC3L304	
LC4L204L		LC4L304	
LC5L204L		LC5L304	
LC6L204L		LC6L304	

#B (54) 1 ^{ÈRE} MOLAIRE NORMALE MAXILLAIRE DROITE			
REFILL	QTÉ	TRY-IN	QTÉ
DUR1206L		DUR1306	
DUR2206L		DUR2306	
DUR3206L		DUR3306	
DUR4206L		DUR4306	
DUR5206L		DUR5306	
DUR6206L		DUR6306	
DUR7206L		DUR7306	

#I (64) 1 ^{ÈRE} MOLAIRE NORMALE MAXILLAIRE GAUCHE			
REFILL	QTÉ	TRY-IN	QTÉ
DUL1206L		DUL1306	
DUL2206L		DUL2306	
DUL3206L		DUL3306	
DUL4206L		DUL4306	
DUL5206L		DUL5306	
DUL6206L		DUL6306	
DUL7206L		DUL7306	

#S (84) 1 ^{ÈRE} MOLAIRE NORMALE MANDIBULAIRE DROITE			
REFILL	QTÉ	TRY-IN	QTÉ
DLR1206L		DLR1306	
DLR2206L		DLR2306	
DLR3206L		DLR3306	
DLR4206L		DLR4306	
DLR5206L		DLR5306	
DLR6206L		DLR6306	
DLR7206L		DLR7306	

#L (74) 1 ^{ÈRE} MOLAIRE NORMALE MANDIBULAIRE GAUCHE			
REFILL	QTÉ	TRY-IN	QTÉ
DLL1206L		DLL1306	
DLL2206L		DLL2306	
DLL3206L		DLL3306	
DLL4206L		DLL4306	
DLL5206L		DLL5306	
DLL6206L		DLL6306	
DLL7206L		DLL7306	

#B (54) 1 ^{ÈRE} MOLAIRE ÉTROITE MAXILLAIRE DROITE			
REFILL	QTÉ	TRY-IN	QTÉ
DUR1207L		DUR1307	
DUR2207L		DUR2307	
DUR3207L		DUR3307	
DUR4207L		DUR4307	
DUR5207L		DUR5307	
DUR6207L		DUR6307	
DUR7207L		DUR7307	

#I (64) 1 ^{ÈRE} MOLAIRE ÉTROITE MAXILLAIRE GAUCHE			
REFILL	QTÉ	TRY-IN	QTÉ
DUL1207L		DUL1307	
DUL2207L		DUL2307	
DUL3207L		DUL3307	
DUL4207L		DUL4307	
DUL5207L		DUL5307	
DUL6207L		DUL6307	
DUL7207L		DUL7307	

#S (84) 1 ^{ÈRE} MOLAIRE ÉTROITE MANDIBULAIRE DROITE			
REFILL	QTÉ	TRY-IN	QTÉ
DLR1207L		DLR1307	
DLR2207L		DLR2307	
DLR3207L		DLR3307	
DLR4207L		DLR4307	
DLR5207L		DLR5307	
DLR6207L		DLR6307	
DLR7207L		DLR7307	

#L (74) 1 ^{ÈRE} MOLAIRE ÉTROITE MANDIBULAIRE GAUCHE			
REFILL	QTÉ	TRY-IN	QTÉ
DLL1207L		DLL1307	
DLL2207L		DLL2307	
DLL3207L		DLL3307	
DLL4207L		DLL4307	
DLL5207L		DLL5307	
DLL6207L		DLL6307	
DLL7207L		DLL7307	

#A (55) 2 ^{ÈME} MOLAIRE NORMALE MAXILLAIRE DROITE				#J (65) 2 ^{ÈME} MOLAIRE NORMALE MAXILLAIRE GAUCHE				#T (85) 2 ^{ÈME} MOLAIRE NORMALE MANDIBULAIRE DROITE				#K (75) 2 ^{ÈME} MOLAIRE NORMALE MANDIBULAIRE GAUCHE			
REFILL	QTÉ	TRY-IN	QTÉ	REFILL	QTÉ	TRY-IN	QTÉ	REFILL	QTÉ	TRY-IN	QTÉ	REFILL	QTÉ	TRY-IN	QTÉ
EUR1206L		EUR1306		EUL1206L		EUL1306		ELR1206L		ELR1306		ELL1206L		ELL1306	
EUR2206L		EUR2306		EUL2206L		EUL2306		ELR2206L		ELR2306		ELL2206L		ELL2306	
EUR3206L		EUR3306		EUL3206L		EUL3306		ELR3206L		ELR3306		ELL3206L		ELL3306	
EUR4206L		EUR4306		EUL4206L		EUL4306		ELR4206L		ELR4306		ELL4206L		ELL4306	
EUR5206L		EUR5306		EUL5206L		EUL5306		ELR5206L		ELR5306		ELL5206L		ELL5306	
EUR6206L		EUR6306		EUL6206L		EUL6306		ELR6206L		ELR6306		ELL6206L		ELL6306	
EUR7206L		EUR7306		EUL7206L		EUL7306		ELR7206L		ELR7306		ELL7206L		ELL7306	

#A (55) 2 ^{ÈME} MOLAIRE ÉTROITE MAXILLAIRE DROITE				#J (65) 2 ^{ÈME} MOLAIRE ÉTROITE MAXILLAIRE GAUCHE				#T (85) 2 ^{ÈME} MOLAIRE ÉTROITE MANDIBULAIRE DROITE				#K (75) 2 ^{ÈME} MOLAIRE ÉTROITE MANDIBULAIRE GAUCHE			
REFILL	QTÉ	TRY-IN	QTÉ	REFILL	QTÉ	TRY-IN	QTÉ	REFILL	QTÉ	TRY-IN	QTÉ	REFILL	QTÉ	TRY-IN	QTÉ
EUR1207L		EUR1307		EUL1207L		EUL1307		ELR1207L		ELR1307		ELL1207L		ELL1307	
EUR2207L		EUR2307		EUL2207L		EUL2307		ELR2207L		ELR2307		ELL2207L		ELL2307	
EUR3207L		EUR3307		EUL3207L		EUL3307		ELR3207L		ELR3307		ELL3207L		ELL3307	
EUR4207L		EUR4307		EUL4207L		EUL4307		ELR4207L		ELR4307		ELL4207L		ELL4307	
EUR5207L		EUR5307		EUL5207L		EUL5307		ELR5207L		ELR5307		ELL5207L		ELL5307	
EUR6207L		EUR6307		EUL6207L		EUL6307		ELR6207L		ELR6307		ELL6207L		ELL6307	
EUR7207L		EUR7307		EUL7207L		EUL7307		ELR7207L		ELR7307		ELL7207L		ELL7307	

#3 (16) MOLAIRE PERMANENTE MAXILLAIRE DROITE				#14 (26) MOLAIRE PERMANENTE MAXILLAIRE GAUCHE				#30 (46) MOLAIRE PERMANENTE MANDIBULAIRE DROITE				#19 (36) 2 ^{ÈME} MOLAIRE ÉTROITE MANDIBULAIRE GAUCHE			
REFILL	QTÉ	TRY-IN	QTÉ	REFILL	QTÉ	TRY-IN	QTÉ	REFILL	QTÉ	TRY-IN	QTÉ	REFILL	QTÉ	TRY-IN	QTÉ
Y6UR2250A2		Y6UR2350		Y6UL2250A2		Y6UL2350		Y6LR2250A2		Y6LR2350		Y6LL2250A2		Y6LL2350	
Y6UR3250A2		Y6UR3350		Y6UL3250A2		Y6UL3350		Y6LR3250A2		Y6LR3350		Y6LL3250A2		Y6LL3350	
Y6UR4250A2		Y6UR4350		Y6UL4250A2		Y6UL4350		Y6LR4250A2		Y6LR4350		Y6LL4250A2		Y6LL4350	
Y6UR5250A2		Y6UR5350		Y6UL5250A2		Y6UL5350		Y6LR5250A2		Y6LR5350		Y6LL5250A2		Y6LL5350	
Y6UR6250A2		Y6UR6350		Y6UL6250A2		Y6UL6350		Y6LR6250A2		Y6LR6350		Y6LL6250A2		Y6LL6350	
Y6UR7250A2		Y6UR7350		Y6UL7250A2		Y6UL7350		Y6LR7250A2		Y6LR7350		Y6LL7250A2		Y6LL7350	

COURONNES ACIER

CANINE			
#C/H (53/63) HAUT		#R/M (83/73) BAS	
REFILL	QTÉ Pack de 5	REFILL	QTÉ Pack de 5
C1604		LC1604	
C2604		LC2604	
C3604		LC3604	
C4604		LC4604	
C5604		LC5604	
C6604		LC6604	

REFILL	QTÉ Pack de 5
SSC	

1 ^{ÈRE} MOLAIRE							
#B (54) MAXILLAIRE DROITE		#I (64) MAXILLAIRE GAUCHE		#S (84) MANDIBULAIRE DROITE		#L (74) MANDIBULAIRE GAUCHE	
REFILL	QTÉ Pack de 5	REFILL	QTÉ Pack de 5	REFILL	QTÉ Pack de 5	REFILL	QTÉ Pack de 5
DUR2606		DUL2606		DLR2606		DLL2606	
DUR3606		DUL3606		DLR3606		DLL3606	
DUR4606		DUL4606		DLR4606		DLL4606	
DUR5606		DUL5606		DLR5606		DLL5606	
DUR6606		DUL6606		DLR6606		DLL6606	
DUR7606		DUL7606		DLR7606		DLL7606	

2 ^{ÈME} MOLAIRE							
#A (55) MAXILLAIRE DROITE		#J (65) MAXILLAIRE GAUCHE		#T (85) MANDIBULAIRE DROITE		#K (75) MANDIBULAIRE GAUCHE	
REFILL	QTÉ Pack de 5	REFILL	QTÉ Pack de 5	REFILL	QTÉ Pack de 5	REFILL	QTÉ Pack de 5
EUR2606		EUL2606		ELR2606		ELL2606	
EUR3606		EUL3606		ELR3606		ELL3606	
EUR4606		EUL4606		ELR4606		ELL4606	
EUR5606		EUL5606		ELR5606		ELL5606	
EUR6606		EUL6606		ELR6606		ELL6606	
EUR7606		EUL7606		ELR7606		ELL7606	