



PROMOTIONS | 2025
DU 01 SEPTEMBRE AU 31 OCTOBRE



L'EXCELLENCE AU SERVICE DES CABINETS DENTAIRES



**AVALON
BIOMED**
Advanced Bioceramics



Matériel premium, design moderne, décliné en plusieurs couleurs pour s'adapter à votre environnement. Avec Prodentalpes, offrez à votre cabinet des équipements alliant performance, confort et esthétique.

NOS ATOUTS

- ✓ **Qualité et fiabilité** – Des produits sélectionnés pour leur durabilité et leur efficacité
- ✓ **Confort et ergonomie** – Pensés pour améliorer l'expérience des praticiens et des patients.
- ✓ **Service expert et réactif** – Un accompagnement personnalisé pour répondre à vos besoins.

CONTACTEZ-NOUS

✉ contact@prodentalpes.fr

☎ 06 01 21 16 35



prodentalpes.fr

ZI DES DRAGIEZ, 30 RUE DE GRÉBELIN,
74800 LA ROCHE-SUR-FORON

NeoPUTTY®

MATÉRIAU DE TRAITEMENT PRÉMÉLANGÉ DES RACINES ET DE LA PULPE



Seringue sans déchets
avec embout à piston

La facilité d'utilisation de NeoPUTTY offre des résultats prévisibles et de qualité constante dans un environnement sec ou humide, qu'il s'agisse de combler une perforation, de réaliser une thérapie pulpaire vitale ou une chirurgie apicale.

– Sayeed Attar, DDS, MS
Endodontiste


UNE NORME SUPÉRIEURE EN MATIÈRE DE BIOCÉRAMIQUE

NeoPUTTY est prémélangé et optimisé pour une manipulation et une mise en place plus efficace. Sa consistance ferme et peu collante, sa résistance au rinçage et sa bioactivité en font le premier biocéramique pour vos procédures les plus importantes.

NeoPUTTY offre d'excellentes performances pour les procédures dentaires en contact avec la pulpe vitale et les tissus périradiculaires.

LA RADIOCAPACITÉ LA PLUS ÉLEVÉE DE SA CATÉGORIE

Radiopacité équivalente à 8,1 mm Al.

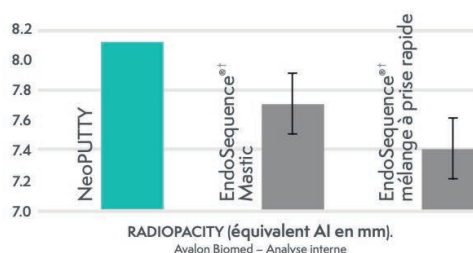

[†] EndoSequence® BC RRM-Putty™ and BC RRM-Fast Set Putty™ are trademarks of Peter Brasseler Holdings LLC.

¹ J Dent. 2014 May;42(5):517-33. A review of the bioactivity of hydraulic calcium silicate cements.

Niu LN, Jiao K, Wang TD, Zhang W, Camilleri J, Bergeron BE, Feng HL, Mao J, Chen JH, Pashley DH, Tay FR.

DIMENSIONNELLEMENT STABLE

Sans rétraction pour assurer un joint sans interstice, minimisant les possibilités d'infiltration bactérienne.

NeoPUTTY 0.08% d'expansion

ADA 57 std. ≤1% de retrait & ≤0.1% d'expansion

RÉSISTANT AU RINÇAGE IMMÉDIAT

Reste en place pour que vous puissiez compléter efficacement la procédure, en assurant un bénéfice bioactif.

TEMPS DE TRAVAIL PROLONGÉ



**Prise in vivo en présence d'humidité

1 NEO PUTTY ACHETÉ, 1 BASELINER OFFERT FOND DE CAVITÉ (AUTO & PHOTO)



✓ **OFFRE DES RÉSULTATS PRÉVISIBLES ET DE QUALITÉ CONSTANTE DANS UN ENVIRONNEMENT SEC OU HUMIDE**

Qu'il s'agisse de combler une perforation, de réaliser une thérapie pulpaire vitale ou une chirurgie apicale. Un coiffage pulpaire, une effraction pulpaire, une pulpotomie (**équivalent Biodentine - trisilicate de calcium**)

✓ **UTILISATION**

- 1- Mettre le produit de Neoputty au bout de l'instrument à l'endroit voulu.
- 2- Dans la séance, mettre du Base/Liner Activa qui est auto-photo et qui dégage du fluor, du phosphate de calcium (Ref : VB2), Biocompatible avec le Neoputty.
- 3- Vous pouvez à la suite mettre du composite dessus sur la base liner VB2 durant la séance.

NEOPUTTY®

Coiffage pulpaire



Packaging : Kit de 0,5 g

Prix public par 1 : 69€^{TTC} / 57,50€^{HT}

Prix public par 3 : 64€^{TTC} / 53,33€^{HT}

Packaging : Kit de 1,2 g

Prix public : 149€^{TTC} / 124,17€^{HT}

Réf : NNPPK 
Packaging : Kit de 2,4 g
(2 seringues NuSmile de 1,2 g)

Prix public : 289€^{TTC} / 240,83€^{HT}

Neo Putty

-Ref : ANPIK - 0.5g - 69€ TTC

-Ref : ANPPK - 1.2 g - 149 € TTC

-Ref : NNPPK - 2.4 G - 289 € TTC



- Trisilicate de calcium
- Pas de dessèchement
- La radiopacité la plus élevée de sa catégorie

-Offre des résultats prévisibles et de qualité constante dans un environnement sec ou humide, qu'il s'agisse de combler une perforation, de réaliser une thérapie pulpaire vitale ou une chirurgie apicale. Un coiffage pulpaire, une effraction pulpaire, une pulpotomie (équivalent Biodentine - trisilicate de calcium)

Utilisation :

- 1- Mettre le produit de Neoputty au bout de l'instrument à l'endroit voulu.
- 2- Dans la séance, mettre du Base/Liner Activa qui est auto-photo et qui dégage du fluor, du phosphate de calcium (Ref : VB2), Biocompatible avec le Neoputty.
- 3- Vous pouvez à la suite mettre du composite dessus sur la base liner VB2 durant la séance.



ACTIVA™ BioACTIVE-BASE/LINER™

Protéger, reminéraliser, restaurer



En savoir plus

Caractéristiques principales

- Les propriétés physiques et bioactives aident à protéger la santé de la pulpe et de la dentine
- La libération de calcium, de phosphate et de fluor favorise la reminéralisation
- La résine hydrophile s'adapte intimement à la dentine et la rend étanche
- La résine caoutchoutée, solide et durable, absorbe les chocs et les forces occlusales
- Distribution contrôlée et mise en place précise grâce à des embouts flexibles
- Ne contient pas de bis-GMA, ni de bisphénol A, ni de dérivés du BPA

Utilisation optimale :

- Mettre le neoputty , trisilicate de calcium (équivalent biodentine)
- Mettre ensuite le bioactive base-liner

Activa Bioactive

Base/Liner

Ref : VB1 - VB2

Embout : A20N1 - A50N1

Protéger, Reminéraliser, Restaurer



Les principales caractéristiques sont :


- Les propriétés physiques et bioactives aident à protéger la santé de la pulpe et de la dentine.
 - La libération de calcium, de phosphate et de fluor favorise la reminéralisation.
 - La résine hydrophile s'adapte intimement à la dentine et la rend étanche.
- La résine caoutchoutée, solide et durable, absorbe les chocs et les forces occlusales.
- Distribution contrôlée et mise en place précise grâce à des embouts flexibles.
 - Ne contient pas de bis-GMA, ni de bisphénol A, ni de dérivés du BPA.
 - Mettre sur le NeoPutty, trisilicate de calcium (équivalent Biodentine).
 - Mettre ensuite du bioactive Base Liner.

! LA PULPE N'EST PAS PLATE !

Les couronnes postérieures NuSmile ZR ont une anatomie occlusale uniforme et fine qui suit les contours de la surface occlusale de la dent naturelle, ce qui réduit le risque d'exposition pulpaire par rapport à la conception "Flat-fit" de certaines autres couronnes. Les marques concurrentes de couronnes postérieures en zircone avec un design occlusal "Flat-fit" ont été sujettes à des échecs de cas probablement dus à des expositions pulpaires iatrogènes.


POURQUOI S'Y RISQUER ?

NuSmile
CONTOUR-FIT

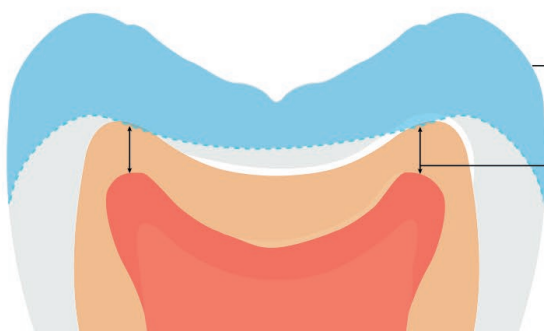

- **Moins de risques d'exposition** pulpaire grâce aux contours naturels de la couronne ZR de NuSmile
- **Moins de taille dentaire nécessaire.** Réduction totale de 1 à 1,5 mm en suivant les contours naturels de l'occlusion.

Autres marques
FLAT-FIT

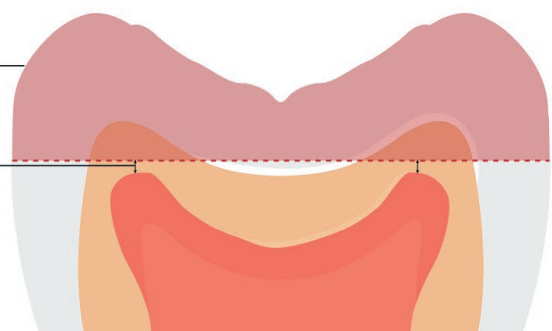

- **Peut être sujet à des échecs** dus à l'exposition iatrogène de la pulpe.
- **Une taille plus importante des dents est nécessaire**

ÉPAISSEUR MINIMALE RÉSISTANCE MAXIMALE

NUSMILE ZR


SURFACE OCCLUSALE
PLUS FINE



0.2mm de marge

SPRIG

SURFACE OCCLUSAL
PLUS ÉPAISSE

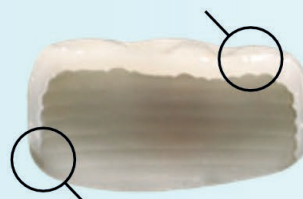

0.5mm de marge

RÉSISTANCE À
LA FRACTURE
2X PLUS
ÉLEVÉE

